


### 采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	眼科手术显微镜（前后节手术）1台
拟采购产品金额	870000.00元
采购项目所属项目名称	眼科手术设备、中医特色干眼诊疗进口类（包3）眼科手术显微镜（前后节手术）1台、白内障超声乳化仪1台、角膜地形图1台、生物测量仪（MASTer）1台
采购项目所属项目金额	1650000.00元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p><b>原因阐述：</b> 国内同类设备无法保障整个治疗过程的安全性，不能满足医院对后发障安全治疗的要求，故申请购置进口设备。</p>	
三、专家论证意见：详见附件	
<p>专家签字：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>2024年10月30日</p> </div>	

# 专家意见表

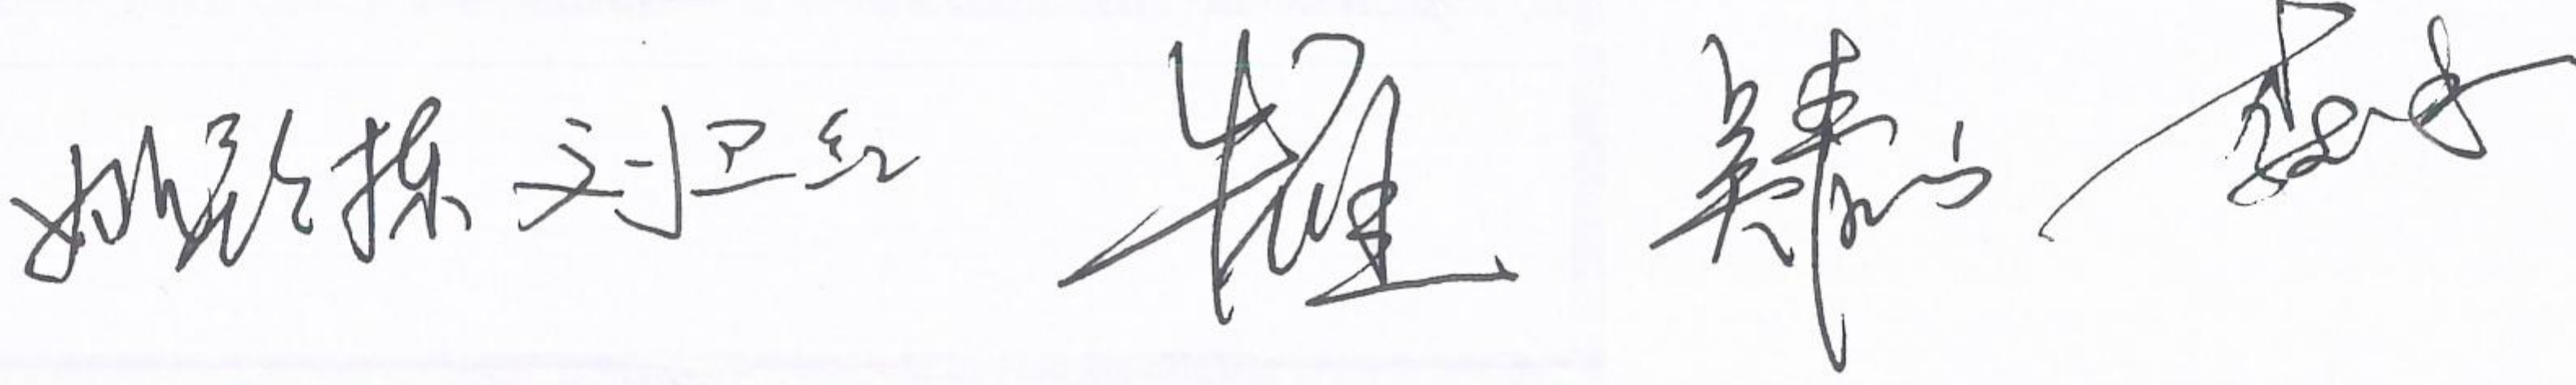

项目名称	眼科手术设备、中医特色干眼诊疗 <sup>进口</sup> 国产类（包3）眼科手术显微镜（前后节手术）1台、白内障超声乳化仪1台、角膜地形图1台、生物测量仪（MASTer）1台
产品名称	眼科手术显微镜（前后节手术）1台
采购人	安阳市中医院

专家意见：

眼科手术显微镜采用进口产品的主要原因包括技术先进性、可靠性和质量安全性。

一、技术先进性具有显著优势。这些设备通常采用先进的光学技术和设计，如T镀膜处理和萤石镜片ApO材质，能够提供更好的光学景深效果和清晰图像，具备无极变倍功能和红光反射，使得手术医生能够更好地观察患者角膜各层、前房、晶体等。

二、在可靠性和质量安全性方面表现优异。国产设备由于技术原因无法提供与进口设备相当的手术野观察效果，无法很好地满足临床需求。进口产品在临床应用中表示出更高的稳定性和可靠性，能确保手术的顺利进行和患者安全。


三、该进口产品的市场需求和用户反馈良好，满足广大患者的服务需求。综上，进口产品多方面优于国产产品，且不属于国家法律法规明确规定限制进口产品，故推荐采购进口产品。

专家人员（签字）：

日期：2024年10月30日

李丹 刘卫红 郭

### 采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	白内障超声乳化仪 1 台
拟采购产品金额	360000.00 元
采购项目所属项目名称	眼科手术设备、中医特色干眼诊疗进口类（包 3）眼科手术显微镜（前后节手术）1 台、白内障超声乳化仪 1 台、角膜地形图 1 台、生物测量仪（MASTer）1 台
采购项目所属项目金额	1650000.00 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<b>原因阐述：</b> 国产产品无法满足临床使用需求，进口产品具有不可替代性，因此我院申请购置进口产品。	
三、专家论证意见：详见附件	
专家签字： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             2024 年 10 月 30 日           </div>	

## 专家意见表



项目名称	眼科手术设备、中医特色干眼诊疗设备类（包3）眼科手术显微镜（前后节手术）1台、白内障超声乳化仪1台、角膜地形图1台、生物测量仪（MASTer）1台
产品名称	白内障超声乳化仪1台
采购人	安阳市中医院

专家意见：

白内障超声乳化仪进口产品，具有安全性、稳定性优势，国产设备不具有负压和灌注压力双压力传感技术，不具有面板实时显示可调流速功能。技术存在不可替代性，且本产品不属于禁止或限制进口目录产品，建议按照《中华人民共和国政府采购法》进行采购进口产品。

专家人员（签字）：


姚红林
刘卫红
程
李林
  



蔡

日期：2024年10月30日

### 采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	角膜地形图 1 台
拟采购产品金额	90000.00 元
采购项目所属项目名称	眼科手术设备、中医特色干眼诊疗进口类（包 3）眼科手术显微镜（前后节手术）1 台、白内障超声乳化仪 1 台、角膜地形图 1 台、生物测量仪（MASTer）1 台
采购项目所属项目金额	1650000.00 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<b>原因阐述：</b> 国产产品无法满足临床使用需求，进口产品具有不可替代性，因此我院申请购置进口产品。	
三、专家论证意见：详见附件	
专家签字： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             2024 年 10 月 30 日           </div>	

## 专家意见表



项目名称	眼科手术设备、中医特色干眼诊疗 <sup>进口</sup> 国产类(包3)眼科手术显微镜(前后节手术)1台、白内障超声乳化仪1台、角膜地形图1台、生物测量仪(MASter)1台
产品名称	角膜地形图1台
采购人	安阳市中医院


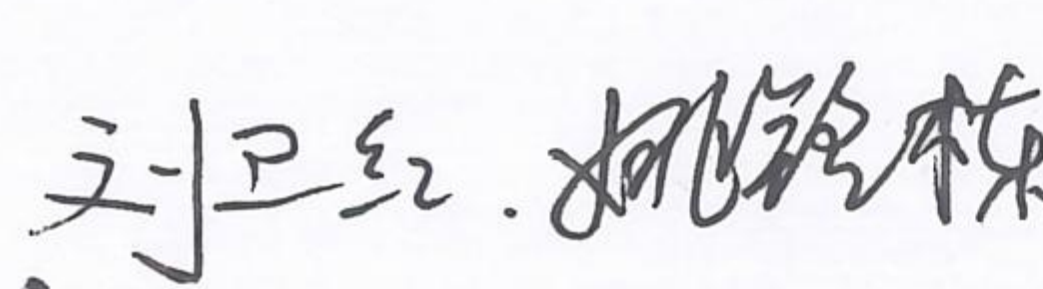


专家意见:

进口角膜地形图在功能完整性、稳定性、精准性、成像能力和清晰度等方面均优于国产产品。进口角膜地形图具有制造精密、性能稳定、操控性好、测量精密度高、故障率低、使用寿命长等优势，在临床使用中能够提供更准确的数据和更高的测量精度。这对于眼科手术和角膜评估至关重要。国产设备在技术上尚有差距，无法满足临床需要。

在长期使用和维护方面，进口设备使用寿命长，故障率低，从而可降低维护成本，节约医院运行费用。





该产品不属于国家法律法规明确规定限制进口产品，故推荐采购进口产品。

专家人员(签字):

日期: 2024年10月30日

### 采购进口产品专家论证意见

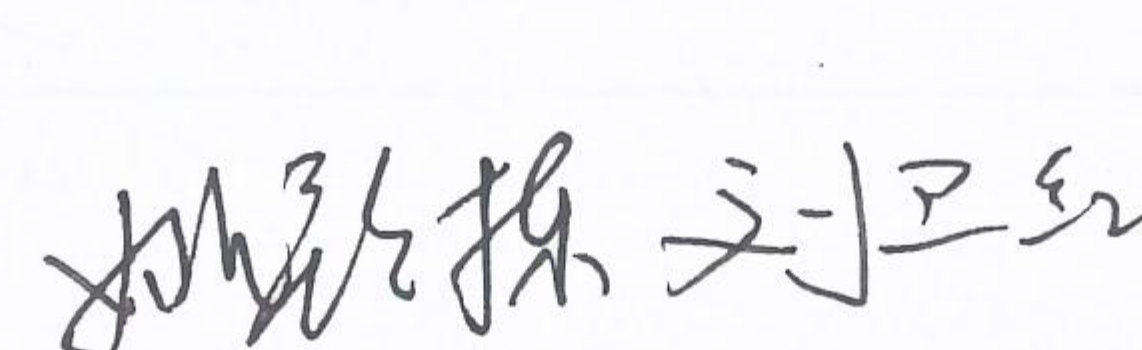一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	生物测量仪 (MASTer) 1 台
拟采购产品金额	330000.00 元
采购项目所属项目名称	眼科手术设备、中医特色干眼诊疗进口类 (包 3) 眼科手术显微镜 (前后节手术) 1 台、白内障超声乳化仪 1 台、角膜地形图 1 台、生物测量仪 (MASTer) 1 台
采购项目所属项目金额	1650000.00 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<b>原因阐述：</b> 国内同类设备无法保障整个生物数据检查过程的准确性，不能满足医院对屈光性白内障安全治疗的要求，故申请购置进口设备。	
三、专家论证意见：详见附件	
专家签字： <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">     </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             2024 年 10 月 30 日           </div>	

专家意见表



项目名称	眼科手术设备、中医特色干眼诊疗国产类（包3）眼科手术显微镜（前后节手术）1台、白内障超声乳化仪1台、角膜地形图1台、生物测量仪（MASTer）1台
产品名称	生物测量仪（MASTer）1台
采购人	安阳市中医院

专家意见：

生物测量仪采购进口产品的主要原因包括以下几方面：

一、测量精度和稳定性：进口生物测量仪在测量精度和稳定性方面优于国产设备，进口产品能够提供更高精度的测量结果，减少误差，降低因测量不准导致的医疗纠纷风险。

二、具有完善的功能性和技术先进性。进口设备具有完善的功能和先进计算公式。例如，进口设备内置白内障手术公认最准确的Holladay 2公式，且晶体数据库完善，能提供更加科学、更加准确的数据支持。

三、能够满足临床需求：进口产品特别是在白内障手术和其他复杂屈光疾病诊断中表现出色。标志性功能包括人工晶体度数计算、眼轴、角膜曲率、前房/前节等参数测量方面，国产设备难以替代。

综上，采购进口产品主要是确保测量的高精度和稳定性，满足复杂的临床需求，且不属于国家法律法规政策规定限制进口产品，故推荐采购进口产品。

专家人员（签字）：

日期：2024年10月30日

甄 刘卫红

李成  
吴伟 刘锦东